

EXCRETA : LANCEZ L'ALERTE !

Établissements médico-sociaux (EMS)

L'objectif de l'étude a été de proposer aux EMS un **état des lieux** du risque lié aux excréta de service disposant ou non de laveurs-désinfecteurs de bassins (LDB) afin d'engager les professionnels via les directeurs et équipes mobiles d'hygiène (EMH) dans une meilleure gestion des excréta à l'aide d'**outils pédagogiques** et de **communication simples**.

Au 15 janvier 2020, la démarche a fait l'objet de **7330 consultations sur le [site Internet](#)**.

La page concernant les Etablissements médico-sociaux ([EMS](#)) **sans LDB** a été visitée 1415 fois, et celle concernant les [EMS avec LDB](#) a été consultée 1042 fois.

32 EMS ont renvoyé leurs données (30 Ehpad, 2 FAM) entre **septembre et décembre 2019, soit 58 services évalués**.

Description des établissements

Type d'EMS	n	Statut	n
Ehpad	30	Privé	4
FAM	2	PSP	6
		Public	19
		Non précisé	3

Capacité	n
<80 places	18
80 et plus	14

Département	n	Région	n
Ain (01)	1	Auvergne-Rhône-Alpes	23
Ardèche (07)	3	Bourgogne-FC	2
Côte d'Or (21)	1	Centre-VdL	1
Eure (27)	1	Hauts-de-France	1
Indre-et-Loire (37)	1	Ile-de-France	1
Haute-Loire (43)	1	Normandie	3
Loire-Atlantique (44)	1	Pays de la Loire	1
Oise (60)	1		
Puy-de-Dôme (63)	12		
Rhône (69)	4		
Saône et Loire (71)	2		
Seine-Maritime (76)	2		
Yvelines (78)	1		
Yonne (89)	1		

Plus du quart des établissements ayant participé sont en dehors de la région Auvergne-Rhône-Alpes.

Rattachement à un ES	
Non	22
Oui	10

Présence d'une équipe mobile d'hygiène (EMH)	
Non	12
Oui	19

¼ des structures participantes ne sont rattachées ni à un établissement de santé ni à une EMH.

L'outil proposé est accessible et facilement utilisable, la moitié des structures participantes ne disposant pas de la présence d'une EMH.


Questionnaire avec laveurs-désinfecteurs de bassins

26 laveurs-désinfecteurs de bassins répartis dans 20 services (sur 12 EMS)

Au moins un LDB par unité/étage	
Non	6
Oui	14

Pour 30% des services, le LDB est partagé entre les étages/unités.

Résultats pour les services avec LDB (n=26 LDB)

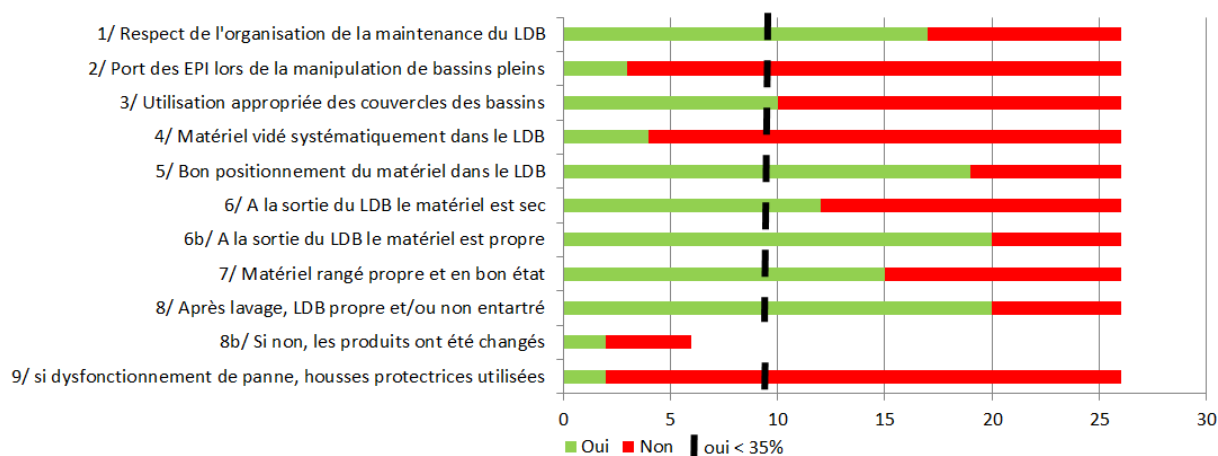

L'évaluation des LDB identifie **4 points critiques majeurs** (< 35% de oui) :

- housses protectrices de bassins, pots de chaise garde-robe non utilisées en cas de dysfonctionnement ou panne
- non port d'équipements de protection individuelle
- matériel (bassins, pots de chaise garde-robe) non vidé systématiquement dans le LDB
- produits non changés si LDB non propre ou entartré


Questionnaire sans laveur-désinfecteur de bassins

38 services ont répondu à l'enquête « sans laveur-désinfecteur de bassins » (sur 21 EMS)

Présence de vidoirs réservés aux excreta	n
Non	33
Oui	5

87% des services n'ont pas de vidoirs réservés aux excreta

Résultats pour les services sans LDB (n=38)

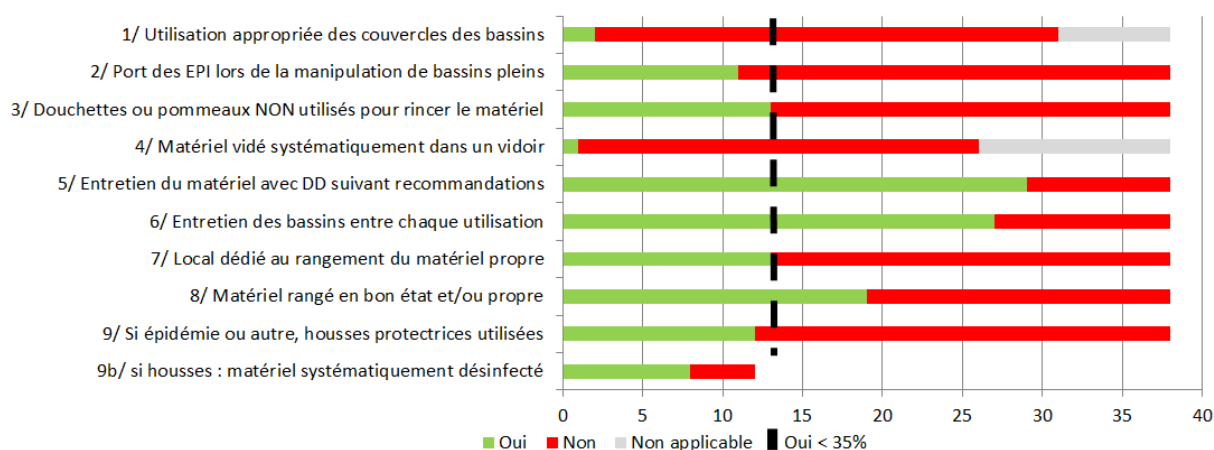

L'évaluation des services sans LDB identifie **5 points critiques majeurs** (< 35% de oui) :

- matériel non vidé systématiquement dans un vidoir
- transports des bassins et pots de chaise garde-robe sans couvercle
- non port d'équipements de protection individuelle
- housses protectrices de bassins, pots de chaise garde-robe non utilisées en cas d'épidémie ou autre.
- douchettes ou pommeaux utilisés pour rincer le matériel

Nous rappelons également l'importance d'un local dédié au rangement du matériel propre (2/3 des services sans LDB n'en ont pas).

Conclusion

Les résultats sont assez comparables à ceux de l'évaluation menée auprès des établissements de santé en 2018.

Pour rappel :

Avec ou sans LDB



SYSTEMATIQUEMENT porter des gants et un tablier à usage unique lors de la manipulation de bassins et urinaux pleins



TOUJOURS vidanger les bassins, pots de chaise garde-robe et urinaux, en fonction des équipements, dans le laveur-désinfecteur de bassins ou le vidoir, pour prévenir la contamination de l'environnement (lavabo, douche, surface...)



En cas de dysfonctionnement du laveur-désinfecteur de bassins ou épidémies, il existe des sacs hygiéniques jetables qui permettent de :

- collecter facilement les excréta
- prévenir la diffusion des odeurs

Avec LDB



REGULIEREMENT vérifier l'état de propreté et l'absence de tartre du laveur-désinfecteur de bassins, sinon **prévoir une maintenance**

Sans LDB



NE JAMAIS utiliser les douchettes ou pommeaux de douches pour rincer les bassins, pots de chaise garde-robe et urinaux, afin d'éviter la contamination de l'environnement et des points d'eau